P Holofote Ultravioleta Móvel

CUIDADO- considerar a instrução de operação!


A montagem de accessórios e também a re-equipagem de componentes de aparelho somente podem ser executadas em concordância com as determinações da instrução de operação.


O holofote ultravioleta móvel pode ser fornecido em duas variações de configuração:

- Aparelho padrão **Spot 30**, consiste do corpo luminoso [3], dois pés de estrutura removíveis [10] (para KS9 adicionalmente 2 cantoneiras de fixação para operação suspensa), a protecção do reflector [4] e do cabo de conexão com ficha de aparelho frio [8] e ficha ultravioleta [9].
- Dispositivo de suspensão **Spot K**, consiste de corpo luminoso [14], da protecção do reflector [13], com o cabo de conexão com a ficha de ultravioleta [11]. Para a operação do equipamento de suspensão é necessário como accessório adicional o dispositivo de suspensão.
  (KS 9 - N° Id.: 50073943 / KS 12 - KS 18 - N° Id.: 50073944)

Montagem e Colocação em Operação:

1. A protecção do reflector [4] é fixada em cada lado com um parafuso de cabeça serrilhada no corpo luminoso [3]. Desparafusar completamente os parafusos serrilhados e retirar a protecção do reflector.
2. Instalação dos aparelhos:
   - ANo aparelho padrão (**Spot 30**) aparafusar os dois pés de estrutura [10] no lado esquerdo e direito com os parafusos de cabeça serrilhada no corpo luminoso. Colocar o aparelho padrão no centro do ambiente útil. Encaixar a ficha de aparelho frio [8] na tomada [7] no corpo luminoso. Conectar a ficha ultravioleta [9] em um dos dois adaptadores ultravioleta internos.
     Para o tipo de aparelho KS 9 existe a possibilidade de operar o reflector ultravioleta em combinação com um dispositivo de suspensão. Para isso serão aparafusadas em vez dos pés da estrutura as cantoneiras [6].
   - Os dispositivos de suspensão (**Spot K**) com os dois ganchos [2] fixar no dispositivo de suspensão [1]. Conectar a ficha ultravioleta [11] em um dos dois adaptadores ultravioleta internos.

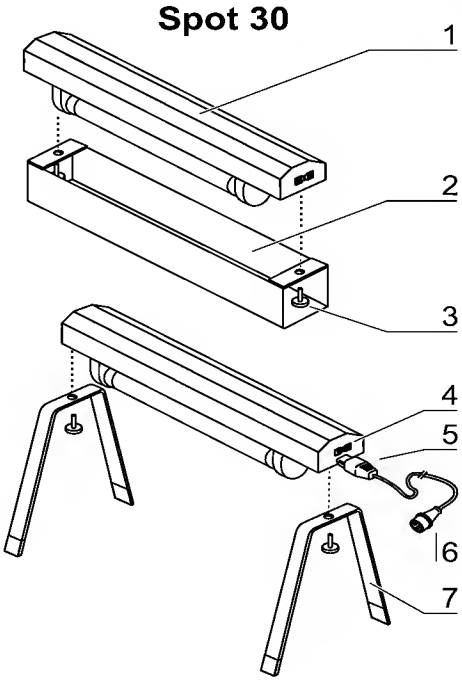

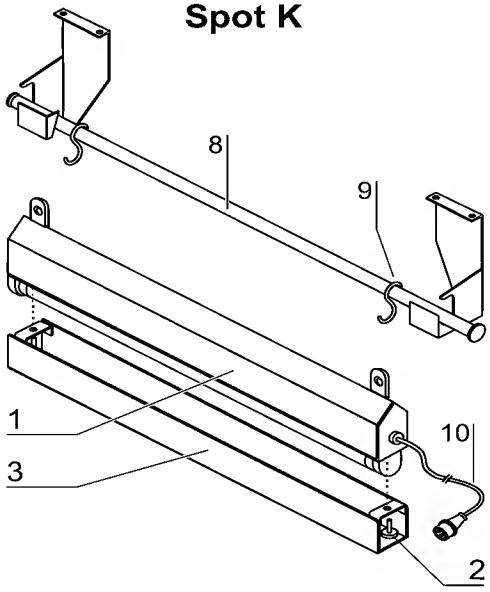

AVISO – Radiação Ultravioleta

Antes que o holofote ultravioleta móvel seja conectado e activado deve ser retirados todos os meios auxiliares e amostras da área útil.

CUIDADO - Perigo de Queimadura!

O holofote ultravioleta atinge temperaturas muito altas durante a desinfecção.
Antes que se desmonte novamente o holofote ultravioleta móvel deixe esfriar suficientemente o corpo luminoso!

P Holofote Ultravioleta Móvel

3. Colocar fora de operação:
   Retirar o cabo de conexão, desparafusar os pés de estrutura do aparelho padrão. Aparafusar a protecção do reflector com os parafusos de cabeça serrilhada no corpo luminoso.

Peças de reposição

Denominação	Número da Encomenda:			
	SPOT 30		SPOT K	
	120 V	230 V	120 V	230 V
Soquete de encaixe de passagem	50043771	50043771	50043771	50043771
Reactor ultravioleta lateralmente 2 x 18 W 230 V		50048679		
Reactor ultravioleta lateralmente 2 x 15 W 120 V	50060299			
Reactor ultravioleta reflector 230 V				50048679
Reactor ultravioleta reflector 120 V			50060299	
Reflector de descontaminação ultravioleta 15 W 435 mm lg		50048537		50048537
Reflector de descontaminação ultravioleta 15 W 435 mm lg, 1	50060298		50060298	
Conductor com conector	50048531	50048531	50048531	50048531
Pé de colocação	50048676	50048676	50048676	50048676
Parafuso de cabeça serrilhada	50049781	50049781	50049781	50049781
Instrução de operação	50077503	50077503	50077503	50077503

Dados Técnicos

Denominação	Unidade	SPOT 30		SPOT K	
Largura	mm	80		60	
Altura	mm	115		170	
Altura com o pé de colocação	mm	310		365	
Comprimento	mm	520		995	
Peso	kg	2		4,5	
Dados Eléctricos					
Tensão eléctrica de funcionamento	Volt	120	230	120	230
Frequência de funcionamento	Hz	60	50	60	50
Comprimento de ondas	nm	254	254	245	245